

HYDRAPEEL PRO II

Station experte multi-soins

Manuel utilisateur

Protocoles Hydrapeel PRO II - © 2026 All Rights Reserved Bēlēnsa Ltd - Ref MUHyf-0526

TABLE DES MATIERES

AVANT / APRÈS L'UTILISATION 3
COMPOSANTS ET INTERFACE 4
Soin Expert Éclat, Hydratation et Fermeté 8
1. Accueil, diagnostic de peau et anamnèse 8
2. Préparation de la peau 8
3. Aquadermabrasion 9
4. Spatule fine vibrante 10
5. Stimulation électrique – EMS 10
6. Radiofréquence 12
7. Ultrasons 13
8. Marteau froid 14
Conseils après soin 14

L'ensemble du contenu de ce document, incluant notamment les textes, protocoles, tableaux, illustrations, schémas, éléments graphiques et mise en page, est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction, représentation, diffusion, modification, adaptation, traduction, exploitation commerciale ou non commerciale, totale ou partielle, de ce document, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de son auteur.

Toute utilisation non autorisée pourra faire l'objet de poursuites conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la propriété intellectuelle. Ce document est destiné à un usage strictement professionnel et informatif. Il ne peut être copié, transmis, vendu, partagé ou intégré à un autre support sans accord préalable écrit.

Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver soigneusement afin de pouvoir vous y référer rapidement à l'avenir.

- Veuillez installer, utiliser et faire fonctionner l'appareil correctement, conformément aux instructions du manuel.
- Ne démontez pas cet appareil et n'en modifiez aucune pièce. Il est strictement interdit d'ouvrir et de retirer le capot ainsi que de démonter l'appareil principal, sauf autorisation expresse de la société distributrice.
- Il est strictement interdit au personnel non qualifié d'effectuer toute opération de maintenance ou de modification.
- En cas de panne pendant le fonctionnement, veuillez prendre contact avec le distributeur mentionné à l'arrière de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné au traitement de maladies.

En cas d'utilisation non conforme aux prescriptions d'usage, la garantie du produit sera exclue et aucune responsabilité ne pourra être engagée à l'encontre du fabricant ou du vendeur.

AVANT / APRÈS L'UTILISATION

Avant la première utilisation

- Connecter les sondes sur les côtés gauche et droit de la machine en fonction des marquages, puis placer les sondes sur leur support.
- Vérifier l'alimentation électrique : 220 V – 50 Hz (10 A).

Avant chaque utilisation

- Nettoyez les sondes avant leur utilisation. L'alcool 70° peut être utilisé sur les parties métalliques des sondes. L'écran ne doit pas être nettoyé à l'alcool mais avec un chiffon doux. Ne plongez ni l'instrument ni ses sondes dans l'eau ou dans d'autres agents de nettoyage.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.
- Assurez-vous que les réservoirs A/B/C sont suffisamment remplis.
- Vérifiez que chaque réservoir est correctement installé, fermement vissé pour s'assurer que le joint d'étanchéité est fonctionnel.
- Vérifiez que le réservoir de récupération est correctement installé, fermement vissé pour s'assurer que le joint d'étanchéité est fonctionnel.

Après l'utilisation

- Nettoyez les sondes après leur utilisation. L'alcool 70° peut être utilisé sur les parties métalliques des sondes. Ne plongez ni l'instrument ni ses sondes dans l'eau ou dans d'autres agents de nettoyage.
- Placer les sondes sur leur support machine.
- En fonction des produits utilisés lors des divers traitements, il est fortement recommandé de lancer une phase de nettoyage des tuyaux de l'appareil, via le menu Aquadermabrasion, en sélectionnant le flacon C qui contient un produit adapté à l'opération.
- Éteindre l'appareil depuis l'interrupteur d'alimentation de la face avant.

COMPOSANTS ET INTERFACE

L'appareil

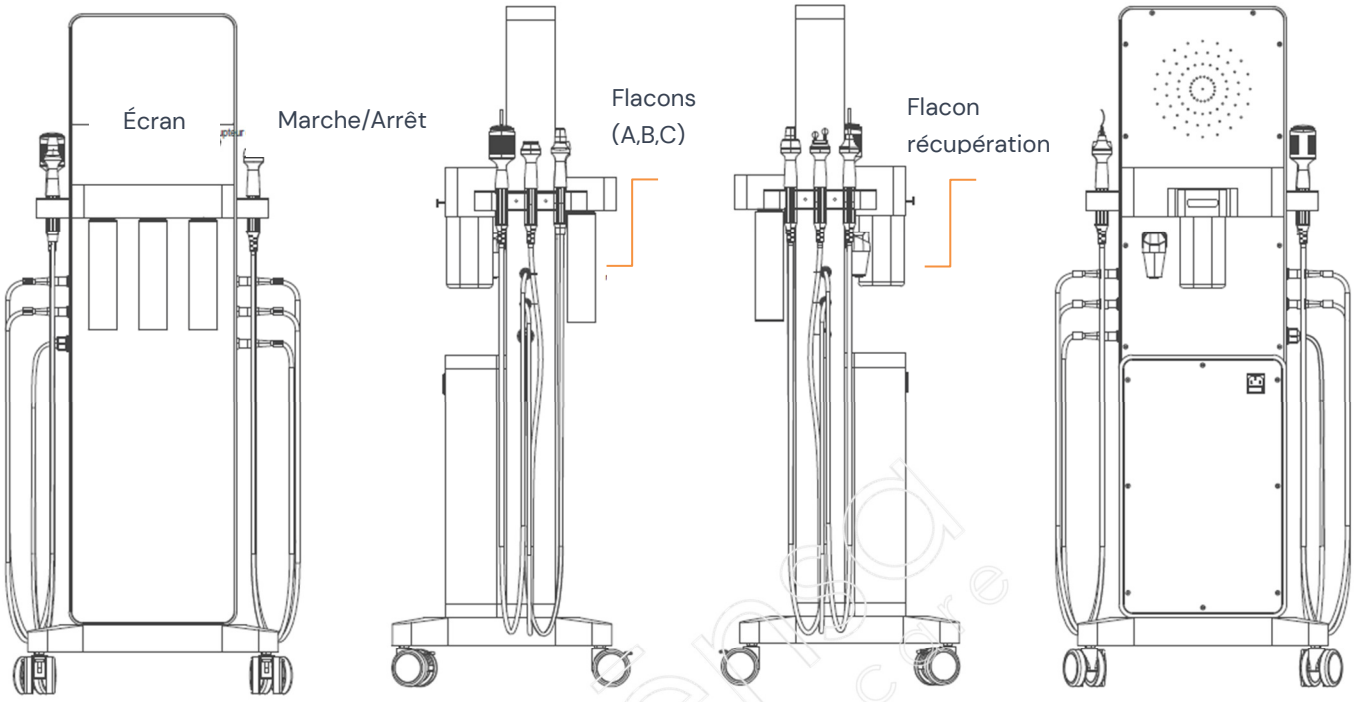

Face | Côté gauche | Côté droit | Face arrière



Les sondes

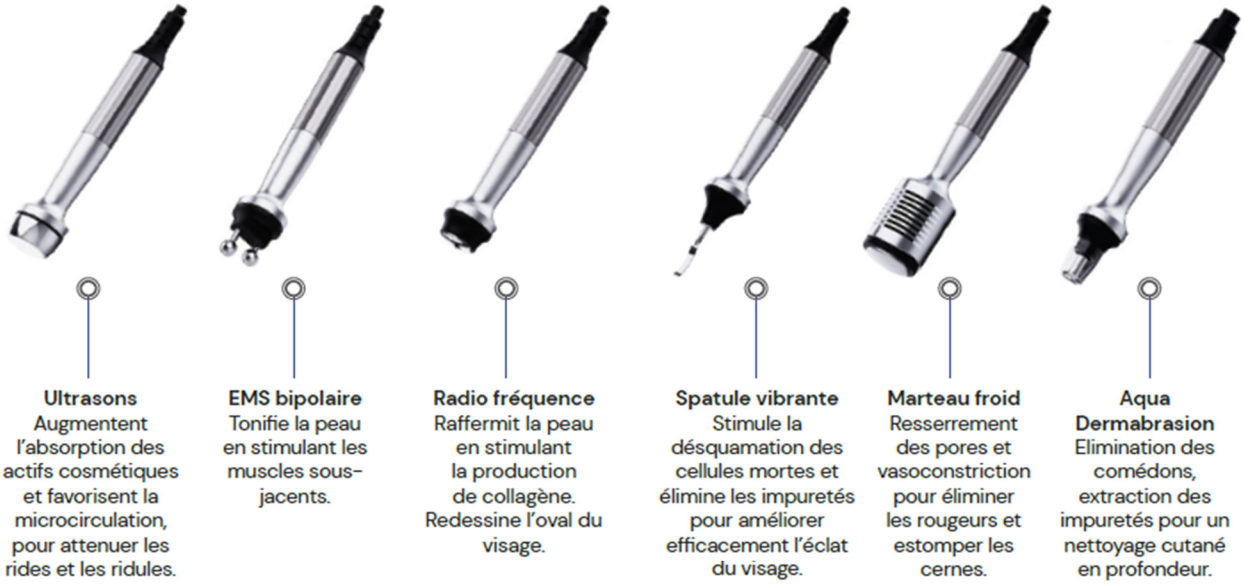

Ultrasons
Augmentent l'absorption des actifs cosmétiques et favorisent la microcirculation, pour attenuer les rides et les ridules.

EMS bipolaire
Tonifie la peau en stimulant les muscles sous-jacents.

Radio fréquence
Raffermit la peau en stimulant la production de collagène. Redessine l'oval du visage.

Spatule vibrante
Stimule la désquamation des cellules mortes et élimine les impuretés pour améliorer efficacement l'éclat du visage.

Marteau froid
Resserrement des pores et vasoconstriction pour éliminer les rougeurs et estomper les cernes.

Aqua Dermabrasion
Elimination des comédons, extraction des impuretés pour un nettoyage cutané en profondeur.

L'Interface

(exemple)



1- Cliquez sur l'interrupteur d'alimentation avant pour accéder à l'écran de démarrage. Patientez 3 à 5 secondes.

Note : il est possible de couper le son émis par la pression sur la sélection des touches en cliquant sur l'icône (rouge) en haut à droite de l'écran de démarrage.

2- Cliquez sur l'écran de démarrage pour accéder à l'interface de sélection des sondes.
3- Cliquez sur l'image de la sonde sélectionnée et l'écran de sélection des paramètres du soin apparaît :

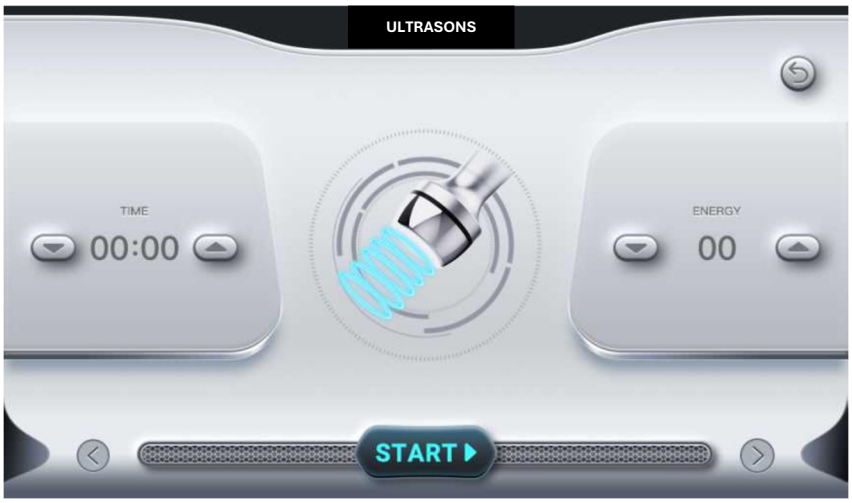

Sur l'écran de paramétrage de la technologie se trouve :

- Temps de traitement – La saisie du temps n'est pas obligatoire pour commencer un traitement.
- Modes ou options disponibles – A, B, C (voir les protocoles selon les technologies). **Cliquer d'abord sur PAUSE pour changer le mode pendant un traitement.**
- Intensité – Sans intensité, la sonde n'est pas active.
- Démarrage du soin (START), arrêt du soin (STOP).
- Retour au menu précédent (icône en haut à droite de l'écran).

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Ultrasons : 1 MHz, 3 W/cm²
Radiofréquence : 1 MHz, 300 mW/cm²
Spécifications EMS : 250 mA
Interface sous Android 11
Écran tactile 10,1 pouces
Dimensions : 41 x 37 x 115 cm (L, l, H)
Poids : 18 kg



© 2026 All Rights Reserved Bēlēnsa Lt

PROTOCOLES DE TRAITEMENT BELENSA POUR APPAREIL HYDRAPEEL PRO II

Important

Les protocoles présentés dans ce document sont établis uniquement pour cet appareil. Ils tiennent compte de ses caractéristiques particulières de puissance, de fréquences et d'intensité des diverses technologies utilisées. Ils ne doivent pas être transposés automatiquement à un autre appareil, même si les technologies semblent identiques. Deux appareils peuvent délivrer une énergie très différente selon leur conception et leurs paramètres techniques et ainsi produire des effets différents, potentiellement néfastes pour la santé.

CONTRE-INDICATIONS

- Grossesse, allaitement.
- Pacemaker, implants électroniques ou troubles cardiaques.
- Cancer en cours ou antécédent récent sans avis médical.
- Affections cutanées sur les zones traitées telles que : plaies ouvertes, brûlures, eczéma actif, psoriasis inflammatoire, herpès actif, acné sévère inflammatoire.
- Injections récentes, fils tenseurs récents ou chirurgie esthétique récente.
- Traitement dermatologique agressif récent, peeling médical ou laser récent.
- Implants métalliques importants dans la zone traitée.
- Pathologie thyroïdienne en cours.

Les contre-indications mentionnées ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive. D'autres situations médicales, traitements ou sensibilités particulières peuvent nécessiter le report ou l'annulation du soin. Il est de la responsabilité du/de la praticien/ne de réaliser un questionnaire préalable et en cas de doute, d'orienter le/la client/e vers un avis médical avant l'utilisation de l'appareil.

PRODUITS / ACCESSOIRES

Les accessoires à prévoir pour l'utilisation des technologies de manière sécurisée et efficace sont :

- Gel conducteur (Ultrasons)
- Produits de soins à base aqueuse (Ultrasons)
- Thermomètre, Gel de confort (Radio-fréquence)
- Sérum de contact (EMS stimulation électrique)
- Produit kératolytique (Flacon A)
- Produit hydratant (flacon B)
- Produit de nettoyage des tuyaux de la machine (flacon C)

© 2026 All Rights Reserved Bēlēnsa Ltd - Ref MUHyf-0526

SOIN EXPERT ÉCLAT, HYDRATATION ET FERMETÉ

Le protocole suivant est un protocole complet de soin esthétique visage impliquant toutes les technologies présentes sur l'appareil : Aquadermabrasion – Spatule vibrante – EMS – Radiofréquence – Ultrasons – Marteau froid.

Ce protocole peut être « découpé » en plusieurs protocoles indépendants selon les technologies en fonction des contraintes cutanées, de temps, de budget, etc. Par exemple : « Aquadermabrasion + Ultrasons » ou « EMS stimulation électrique + Ultrasons » ou « Radiofréquence + marteau froid » etc.

Durée totale conseillée : de 60 à 90 minutes (hors accueil, diagnostic et anamnèse).

Objectifs du soin : Ce protocole vise à nettoyer la peau en profondeur, affiner le grain de peau, favoriser l'éclat du teint, stimuler la tonicité cutanée, améliorer la pénétration des actifs et apaiser la peau en fin de soin. Il est particulièrement adapté aux peaux ternes, déshydratées, fatiguées, épaissies, avec pores dilatés, relâchement léger ou manque d'éclat. L'ordre choisi des technologies utilisées lors de ce soin est axé sur le confort client, sans compromis avec l'efficacité du protocole.

1. ACCUEIL, DIAGNOSTIC DE PEAU ET ANAMNÈSE

Protocole d'accueil esthétique, explications des technologies

Se référer aux contre-indications

2. PRÉPARATION DE LA PEAU

Objectif : préparer la peau à recevoir les soins suivants pour en maximiser l'efficacité.

Action	Zone	Produits recommandés	Durée
Démaquillage	Visage, cou		3 - 5 minutes
Gommage	Visage, cou		Gommage enzymatique Pumpline (éviter un gommage trop agressif si le soin se poursuit par l'aquadermabrasion) 5 minutes
Rincer	Visage, cou	Eau tiède ou compresses humides	2 minutes
Sécher	Visage, cou	Mouchoirs ou serviette propre	

3. AQUADERMABRASION

Objectif : Nettoyer en profondeur, désincruster les pores, éliminer les cellules mortes et préparer la peau à recevoir les actifs.

Action	Zone	Produits recommandés	Durée
Nettoyage en profondeur	Visage, cou	Solution éclat exfoliante Flacon – A Embout « Aqua derma »	5 - 8 minutes
Option (si soin Aqua dermabrasion uniquement)			
Hydratation	Visage, cou	Solution Hydratation Flacon – B Embout « Vortex »	5 - 8 minutes

Technique



Sélectionnez le flacon de solution A (aquadermabrasion), B (hydratation) ou C (nettoyage des tuyaux).

Réglez le débit de solution et la pression d'aspiration en fonction de la zone et de la morphologie du visage à traiter.

Mettez la sonde en contact avec la peau et patientez quelques secondes pour que la solution arrive jusqu'à la sonde.

Commencez par le front, puis descendez vers les joues, le nez, le menton et l'ovale du visage.

Effectuez des passages lents et réguliers, sans insister excessivement sur une même zone.

Travailler dans le sens des lignes du visage :

- Front : du centre vers les tempes.
- Joues : du nez vers les oreilles.
- Menton : du centre vers l'extérieur.
- Nez : du haut vers le bas, avec prudence sur les ailes du nez.

Note : sur l'écran de commande de la sonde, cette icône s  e lorsque le récipient de récupération est plein.

Précautions

Éviter le contour immédiat des yeux, les paupières, les zones irritées.

Sur peau sensible, diminuer l'aspiration et réduire le nombre de passages.

4. SPATULE FINE VIBRANTE

Objectif : Parfaire le nettoyage, décoller les impuretés superficielles et favoriser la désincrustation.

Action	Zone	Produits recommandés	Durée
Désincrustation	« T » , ailes du nez, menton	Solution éclat exfoliante flacon A	2 - 5 minutes



Technique

Utiliser un coton bien imbibé de lotion exfoliante Lumyline. La spatule fine ne doit jamais être utilisée sur peau sèche.

Incliner la spatule à environ 30 à 45 degrés et faites-la glisser doucement sur la peau, sans pression excessive. Les modes A/B/C permettent d'augmenter l'énergie pour faciliter la désincrustation, le cas échéant.

Insister légèrement sur :

- Zone T.
- Ailes du nez.
- Menton.

Précautions

Éviter les paupières, le contour des yeux, les zones rouges, irritées ou présentant de l'acné inflammatoire.
Ne pas utiliser trop longtemps au même endroit pour éviter l'irritation.

5. STIMULATION ÉLECTRIQUE – EMS

Objectifs : améliorer la souplesse de la peau et la tonicité des muscles profonds du visage.

Action	Zone	Produits recommandés	Durée
Souplesse et tonicité	Visage Cou	Sérum Éclat Souplesse	10 – 15 minutes 3 minutes



Technique

Mode A - Souplesse de peau / drainage / éclat

Intensité : faible à modérée - 1 à 3/10
Repère cliente : picotement léger, confortable, **sans contraction visible**.
Après avoir imbibé le visage du sérum éclat, travailler en glissé lent, toujours vers le haut et l'extérieur :

- menton → oreilles
- commissures des lèvres → oreilles
- ailes du nez → tempes
- centre du front → tempes
- sourcils → ligne du cuir chevelu, sans passer sur les paupières

© 2026 All Rights Reserved Bēlēnsa Ltd - Ref MUHyf-0526

Mode B – Stimulation musculaire / ovale / tonicité

Intensité : moyenne - 4 à 6/10
Repère cliente : contraction légère à visible, mais jamais douloureuse.
Après avoir imbibé le visage du sérum éclat, placer la sonde sur les zones musculaires, puis faire :
2 à 4 secondes de stimulation + relâchement, puis déplacer légèrement.
Zones utiles

- Ovale du visage : menton vers l'angle de la mâchoire.
- Joues : bas de joue vers la pommette.
- Pommettes : pommette vers la tempe.
- Front : du sourcil vers le haut, avec une intensité douce.
- Sillons nasogéniens : travailler autour, sans insister directement dans le pli.

Règle simple

La **fréquence** choisit le type de stimulation.
L'**énergie** règle la force ressentie.
Le **temps** règle la durée totale du travail**.**

Donc on choisit d'abord le mode/fréquence selon l'objectif, puis on augmente l'énergie progressivement selon la tolérance de la cliente et au fil de la cure.

Réglage selon l'objectif

Objectif	Intensité	Sensation recherchée
Peau sensible / confort	1 à 2/10	Picotement très léger
Souplesse / éclat	2 à 3/10	Picotement confortable
Tonicité légère	3 à 4/10	Petite stimulation
Ovale / muscles visage	4 à 6/10	Contraction visible mais confortable
Cou	1 à 3/10 max.	Très doux, jamais de contraction forte

Précautions

Ne pas utiliser sur les paupières, la gorge, la thyroïde ou près du cœur.

Sur le cou, il faut être très prudent. Ne jamais stimuler :

- la gorge
- la trachée
- la thyroïde
- les carotides
- le centre du cou
- la zone sous le menton

La stimulation de la région antérieure du cou peut provoquer une chute de tension, une stimulation du sinus carotidien ou des spasmes gênants.

Travailler uniquement avec une intensité faible, de 1 à 2/10, maximum 3/10 si la tolérance est très bonne, sur les côtés du cou, jamais au centre.

© 2026 All Rights Reserved Bēlēnsa Ltd - Ref MUHyf-0526

6. RADIOFRÉQUENCE

Objectifs : apporter un effet tenseur, stimuler la fermeté cutanée et améliorer l'aspect du relâchement léger.

Action	Zone	Produits recommandés	Durée
Raffermissement	Visage	Gel confort Hydra	10 – 15 minutes

Technique



Atteindre une température de surface de l'épiderme de 42 °C, en travaillant sur une peau imbibée de gel confort, toujours en mouvement, avec des gestes lents, circulaires ou ascendants.
Mesurer fréquemment cette température à l'aide du thermomètre infrarouge.

Intensité de départ : faible, 2/10, puis augmenter légèrement sur plusieurs minutes (environ 4 min) pour atteindre la température cible sur la zone. La cliente doit ressentir une chaleur agréable, jamais une sensation de brûlure.
Une fois la température cible atteinte, la maintenir sur la zone pendant 3 à 5 min maximum, avec un temps total de 10 à 15 min sur l'ensemble du visage.
Zones possibles :

- Ovale du visage.
- Joues.
- Sillons nasogéniens, sans insister directement.

Précautions

Ne jamais rester fixe avec la pièce à main. Ne pas dépasser le temps d'application spécifié ni la température cible de surface épidermique.
Éviter les rougeurs importantes, la couperose marquée, les zones inflammées, les implants métalliques, les fils tenseurs récents et les injections récentes.
Ne pas passer sur la thyroïde, les paupières ou les lésions cutanées.
Éviter le contour des yeux.

Bēlēnsa swiss skin care

7. ULTRASONS

Objectifs : favoriser la pénétration des actifs pour traiter différents problèmes cutanés, améliorer l'hydratation et apporter un effet revitalisant ou un coup d'éclat immédiat.

Action	Zone	Produits recommandés	Durée
Coup d'éclat	Visage	Gamme de soins cabine Belensa en fonction du traitement choisi.	20 – 25 minutes
	Cou	Gel de contact Hydra	2 minutes



Technique

Appliquer le masque Belensa en fonction du traitement choisi :

- Soin Détoxifiant
- Soin Dr Micheels à la Royalactine
- Soin Novaskin
- Soin Teint unifié
- Soin Vitonic multivitaminée
- Soin Pumpline peaux sèches

Suivez le protocole de chaque soin en scannant le QR code de la boîte de soins.

Intensité : 8 à 10/10 ; réduire à 5/10 dans la zone du contour de l'œil.

Travailler par mouvements lents, circulaires et ascendants, en respectant les lignes de massage :

- Du menton vers les oreilles.
- Des ailes du nez vers les tempes.
- Du centre du front vers les tempes.
- De l'ovale du visage vers le haut.

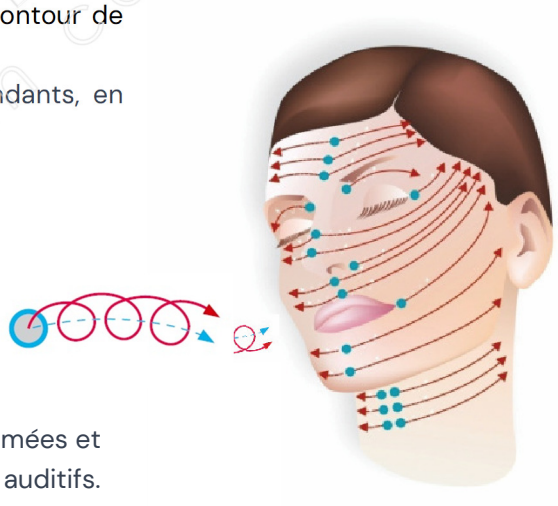

Précautions

Éviter les paupières, la glande thyroïde, les zones inflammées et les implants récents sur la zone, y compris les implants auditifs. Réduire l'intensité sur peau fine ou sensible et dans la zone du contour de l'œil.

Belensa swiss skin care

8. MARTEAU FROID

Objectifs : apaiser la peau, resserrer visuellement les pores et calmer les rougeurs.

Action	Zone	Produits recommandés	Durée
Apaiser	Visage Cou		3 – 5 minutes



L'application du marteau froid peut être très appréciée après un traitement de radiofréquence ou après un soin peeling tel que le soin Novaskin.

Technique

Passer le marteau froid lentement sur l'ensemble du visage. Le gel de confort Hydra peut être utilisé pour une meilleure glisse.

Travailler du centre vers l'extérieur :

- Front vers les tempes.
- Joues vers les oreilles.
- Menton vers l'ovale.
- Contour du visage en mouvements ascendants.

Précautions

Ne pas rester trop longtemps sur une même zone. Ne pas dépasser 5 min d'application afin d'éviter de dépasser la capacité réfrigérante de la sonde.
Pendant le fonctionnement du marteau froid, ne pas obstruer la circulation d'air par les sorties situées de chaque côté de la sonde.

CONSEILS APRÈS SOIN

Pendant les 24 à 48 heures suivant le soin, recommander de :

- Ne pas faire de gommage.
- Éviter sauna, hammam, UV et exposition solaire directe.
- Éviter les actifs irritants : rétinol, acides de fruits, peeling, vitamine C forte.
- Ne pas toucher ou gratter la peau.
- Bien hydrater matin et soir.
- Appliquer une protection solaire en journée.

Une légère rougeur peut apparaître après le soin, surtout après la radiofréquence, la spatule ou l'aquadermabrasion. Elle doit rester temporaire.

Protocoles Hydrapeel PRO II - © 2026 All Rights Reserved Bēlēnsa Ltd - Ref MUHyf-0526